


Carta de trazabilidad



LABORATORIO DE METROLOGÍA DE TEMPERATURA NMX-EC-17025-IMNC-2006

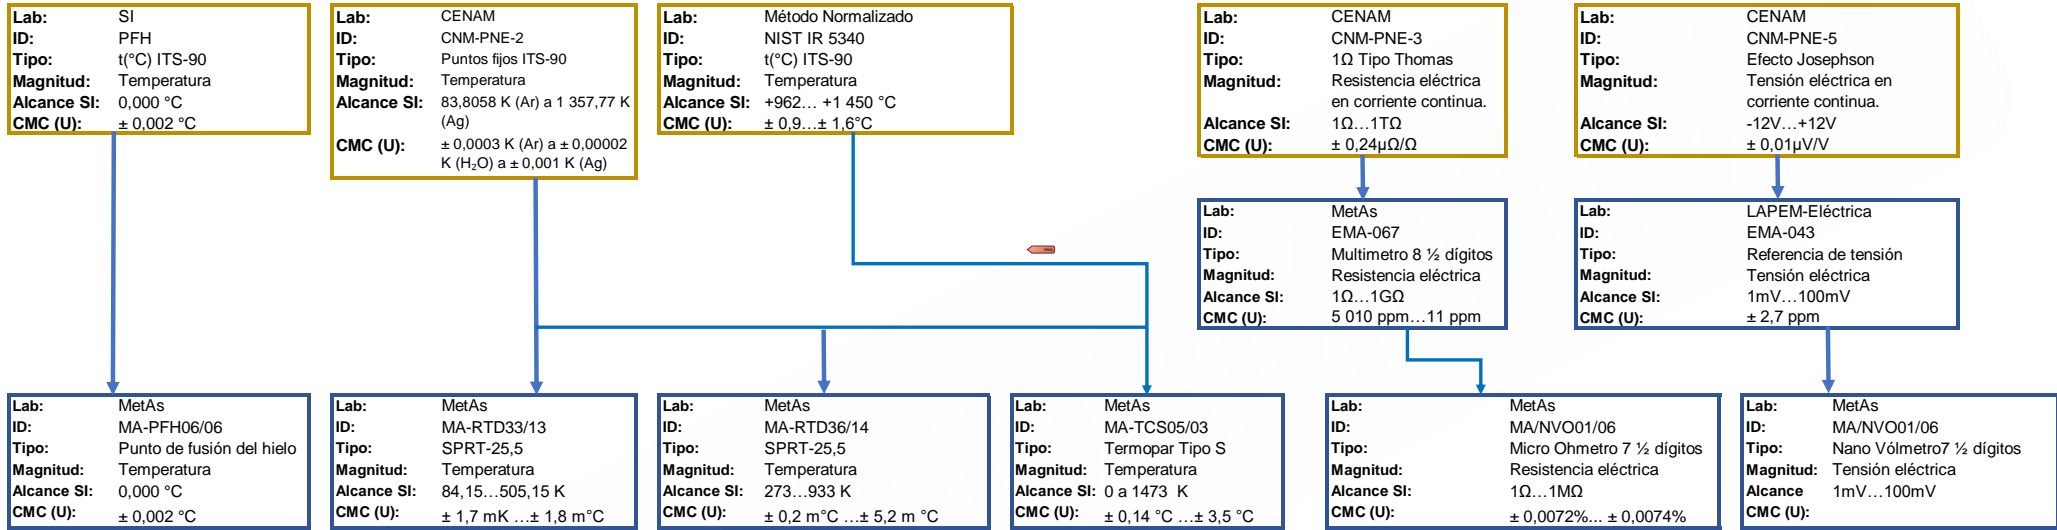

Kratos Metrología S.A. de C.V.

Descripción:	SPTR-100
ID:	PR-T-01
Marca:	Fluke
Magnitud:	Temperatura
Alcance en(SI)	193,237.....928,6018 K
Incertidumbre:	±0,063 °C
Fecha de calibración	2016-02-08

Descripción:	SPTR-100
ID:	PR-T-02
Marca:	Burns Engineering
Magnitud:	Temperatura
Alcance en(SI)	233,15.....273,15 K
Incertidumbre:	±0,25 °C
Fecha de calibración	2015-02-17